



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Fax: 48 (81) 528-89-18

Kanclerz

tel. 48 (81) 528-88-88

Zastępca Kanclerza

tel. 48 (81) 528-88-47

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Z-ca Kanclerza - Kwestor

tel. 48 (81) 528-88-44



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt: Wyposażenie innowacyjnych laboratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami stosowanymi w terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych; Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Priorytet I, Działanie I.3

UM-ZP-262-40/10

Lublin, dnia 02.06.2010 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż Cytometru oraz czytników płytek. Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U./S S87 z dnia 05.05.2010 poz. 130153-2010-PL.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie udziela wyjaśnień na następujące pytania:

Dotyczące zadania nr 2:

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika płytek ELISA, który posiada opcjonalnie możliwość rozbudowy w przyszłości o moduł pomiaru fluorescencji z dołu wraz z TRF, czy moduł ten jest wymagany przez Zamawiającego i powinien być wliczony w koszt czytnika i dostarczony wraz z instrumentem ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający po przeanalizowaniu potrzeb – dopuszcza dostarczenie czytnika płytek który posiada moduł fluorescencji od dołu wraz z TRF jako opcja – przewidzianą do zakupu w przyszłości. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że opcja fluorescencji od góry i inne pozostałe elementy wyposażenia pozostają bez zmian i powinny być wliczone w cenę czytnika.

2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika płytek ELISA, który posiada opcjonalnie możliwość rozbudowy w przyszłości o pomiar w kuwecie, czy moduł ten jest wymagany przez Zamawiającego i powinien być wliczony w koszt czytnika i dostarczony wraz z instrumentem ?

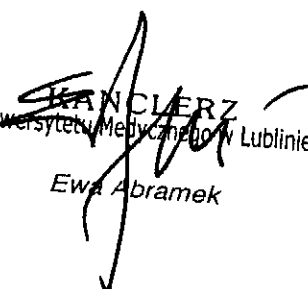
Odpowiedź: Zamawiający informuje: w zestawieniu parametrów podano jednoznacznie, że oczekuje się dostawy czytnika wraz z możliwością pomiarów w kuwecie i ta możliwość jest punktowana w sposób nie powodujący wykluczenia z postępowania. Brak możliwości pomiaru w kuwecie będzie skutkowało tylko zmniejszeniem ilości przyznanych punktów – przewiduje się, że spowoduje to zmniejszenie ilości przyznanych punktów za brak tej możliwości ok. 5 pkt.

Dotyczące zadania nr 3:

1. Czy zamawiający wymaga, aby producent urządzenia był jednocześnie oryginalnym producentem technologii AlphaScreen® i co za tym idzie jedynym podmiotem posiadającym pełną wiedzę i wsparcie techniczne dla tej technologii oraz wszelkie prawa do posługiwania się znakiem towarowym AlphaScreen®.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga, aby producent urządzenia był jednocześnie oryginalnym producentem technologii AlphaScreen® i co za tym idzie jedynym podmiotem posiadającym pełną wiedzę i wsparcie techniczne dla tej technologii oraz wszelkie prawa do posługiwania się znakiem towarowym AlphaScreen®.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.


KAWCZERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramek